



Valve cardiaque transcathéter SAPIEN 3 Ultra avec le système de mise en place Edwards Commander. Transfémoral

Note : Seules certaines étapes sont illustrées sur ce document. Merci de vous référer au document de formation DOC-0139930 pour accéder à l'ensemble des étapes de la préparation du système Edwards Commander.


Préparation du set d'introduction

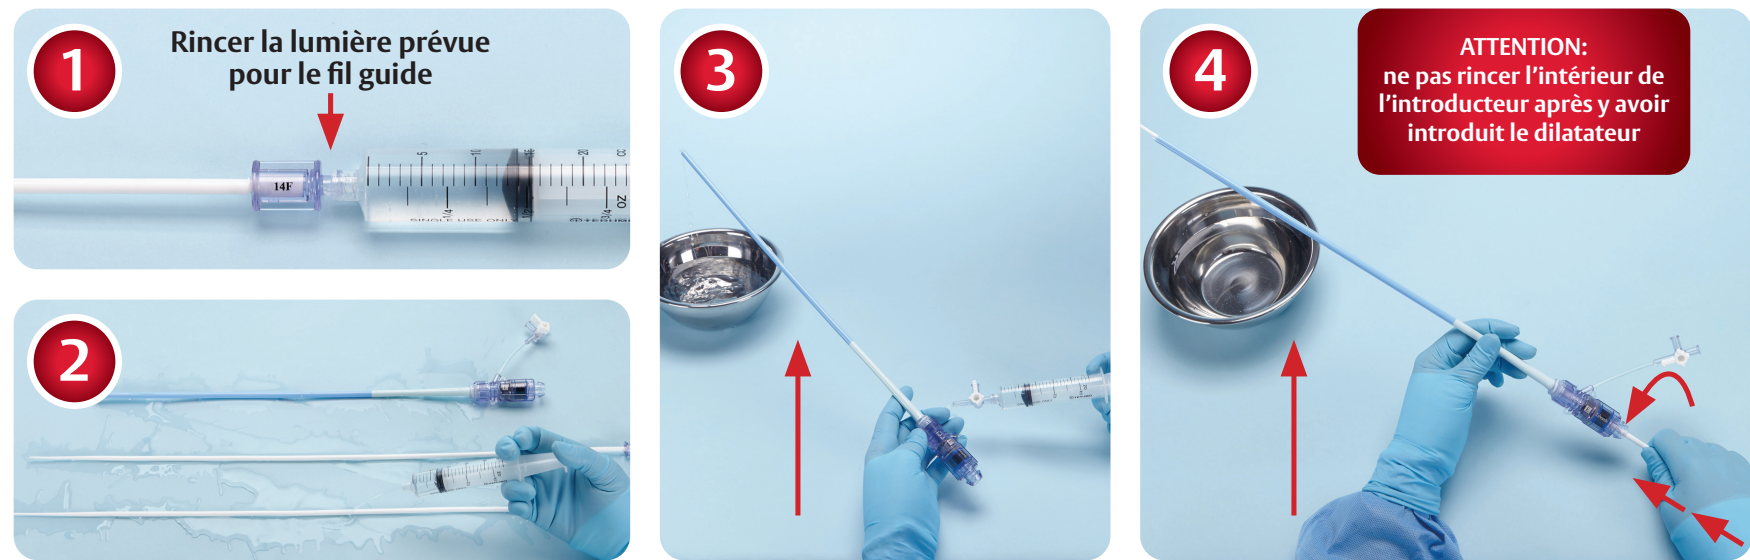

Préparation du système de mise en place

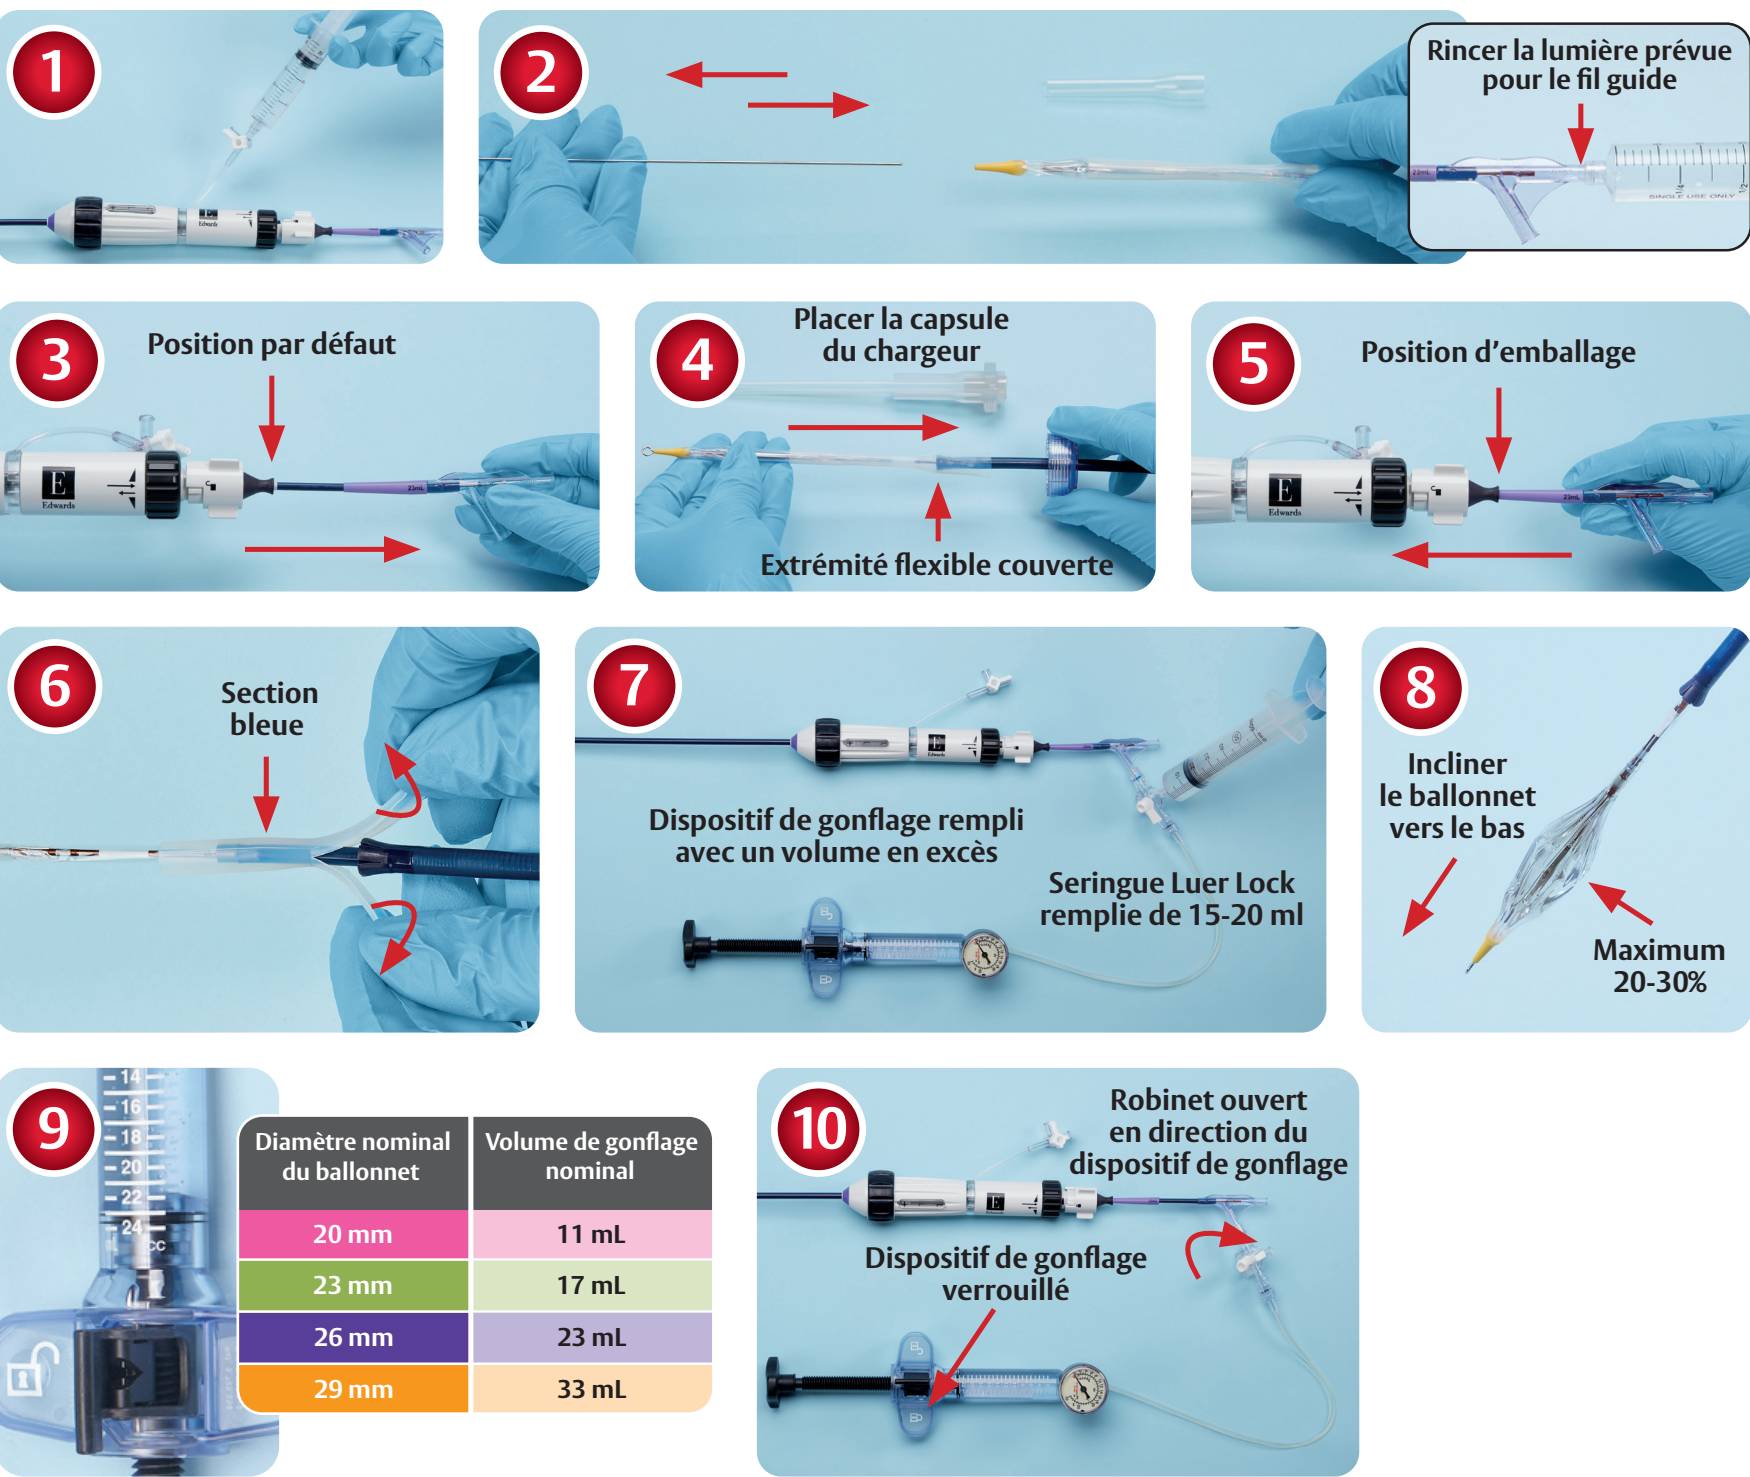

Montage et sertissage

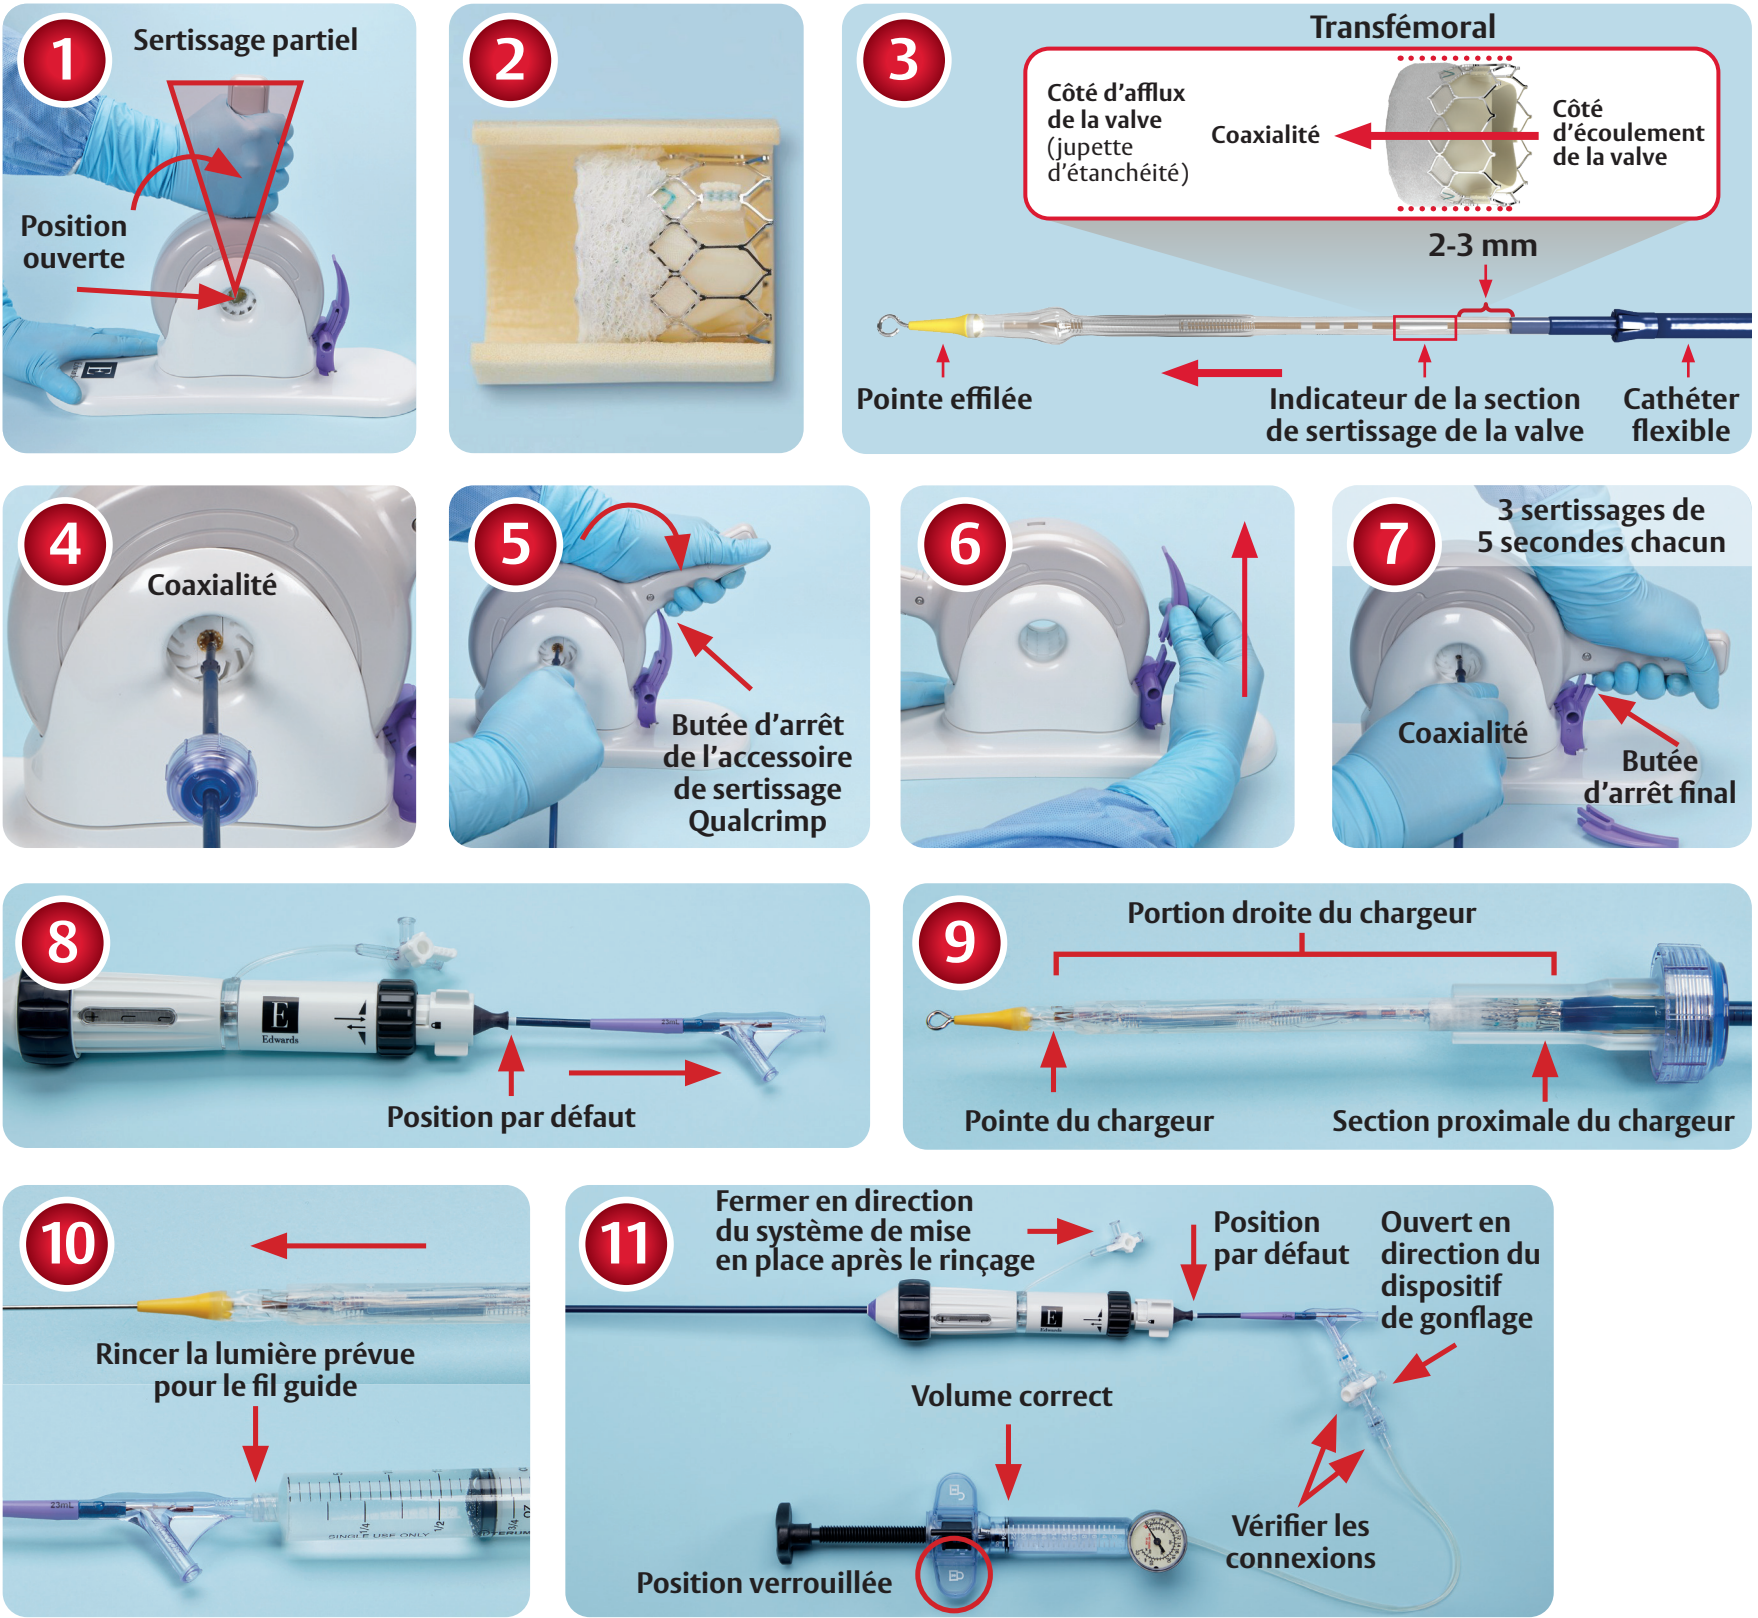

Ceci est un élément de formation.

Pour usage professionnel, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation, notamment pour une information complète concernant les indications, contre-indications, mises en garde, précautions d'emploi et effets indésirables.

Edwards, Edwards Lifesciences, le logo E stylisé, Commander, Edwards Commander, Qualcrimp, SAPIEN, SAPIEN 3 et SAPIEN 3 Ultra sont des marques d'Edwards Lifesciences Corporation.

© 2024 Edwards Lifesciences Corporation. Tous droits réservés. NP--FR-0516 v1.0 - 10/24

Edwards Lifesciences SAS • Immeuble Gershwin, 1 rue Arnold Schoenberg, 78280 Guyancourt.
+33 (0)1 30 05 29 29 • RCS Versailles B 429 487 507

