



Set d'introduction Edwards eSheath+

NOTE: Seules certaines étapes sont illustrées sur ce document. Merci de vous référer à la notice d'utilisation ou au document de formation pour accéder à l'ensemble des étapes de la préparation du set d'introduction Edwards eSheath+.

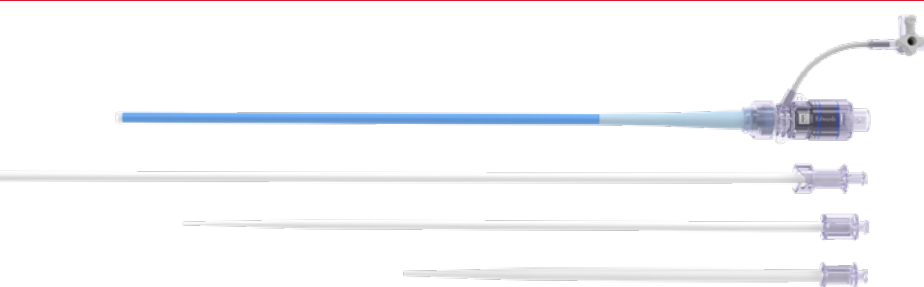

Préparation de la gaine

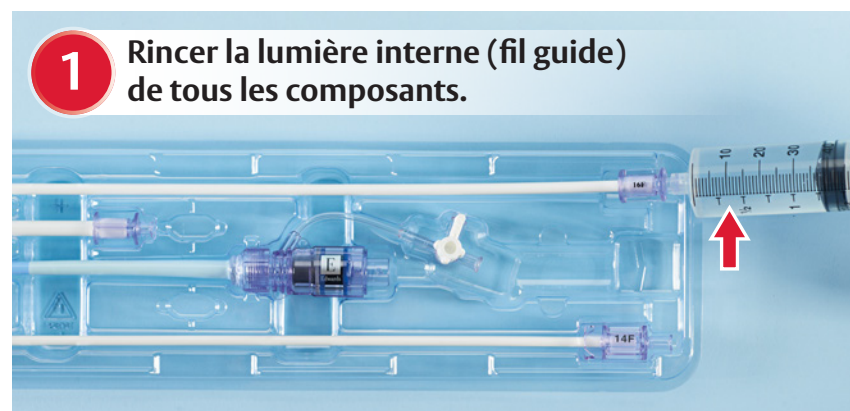

Note

La couture de la gaine peut se dilater un peu après expansion. Le bord relevé peut être aplati en passant un doigt sur le dessus et en le pressant pour le mettre en place. N'appuyer sur la gaine qu'après insertion de l'introducteur.

Ceci est un élément de formation. Pour usage professionnel, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation, notamment pour une information complète concernant les indications, contre-indications, mises en garde, précautions d'emploi et effets indésirables.

Edwards, Edwards Lifesciences, le logo E stylisé, Edwards eSheath, eSheath, et eSheath+ sont des marques d'Edwards Lifesciences Corporation.

© 2025 Edwards Lifesciences Corporation. Tous droits réservés. NP--FR-0666 v1.0 - 12/25

Edwards Lifesciences SAS • Immeuble Gershwin, 1 rue Arnold Schoenberg 78280 Guyancourt • +33 (0)1 30 05 29 29 • RCS Versailles B 429 487 507